

# MARATHON®


## Hautschutzstift mit 100 % Cyanacrylat-Formel

Marathon® ist eine Flüssigkeitsbarriere mit einer Formel auf 100 % Cyanacrylat-Basis, die die Haut vor den negativen Auswirkungen von Feuchtigkeit, Scherkräften und Reibung schützen soll und auf der Haut nicht brennt.<sup>1</sup>




## Stomata

Einschließlich Tracheostoma, Kolostoma, Urostoma etc.<sup>2</sup>




## Hautschäden

Zur Abdeckung von Druckgeschwüren (Dekubitus), Grad I und II, oberflächlichen Verbrennungen und Abschürfungen sowie dem Gewebe um chirurgische Wunden.<sup>2</sup>




## Katheter

Zur Verwendung mit suprapubischen Kathetern, perkutanen endoskopischen Gastrostomiesonden (PEG), chirurgischen Drainagen etc.



## Hautläsionen

Zur Verwendung bei Verletzungen durch medizinische Geräte wie Nasenkanülen, CPAP-Masken (kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck), Geräte zur Unterdrucktherapie etc.<sup>3</sup>




## Mechanische Barriere


Dient dem Schutz der Haut beim Anbringen von Klebevorrichtungen, wie z. B. Verbänden oder Kolostomiekapfen.<sup>2</sup>




## Anwendungsmethoden

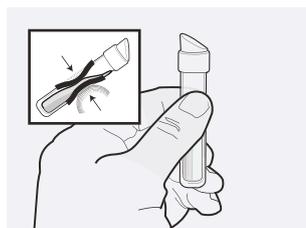


Einhändige Methode

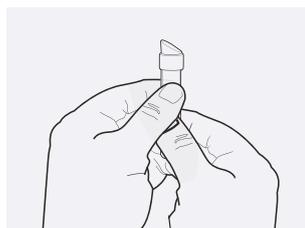

Zweihändige Methode

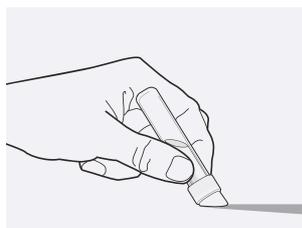

Standardmethode

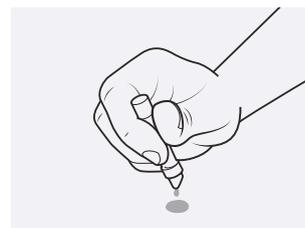


Tropfmethode



**Hinweis:** Versuchen Sie nicht, den Stift durch Knicken oder Biegen zu aktivieren.

# Hautschutz

## Und so funktioniert es

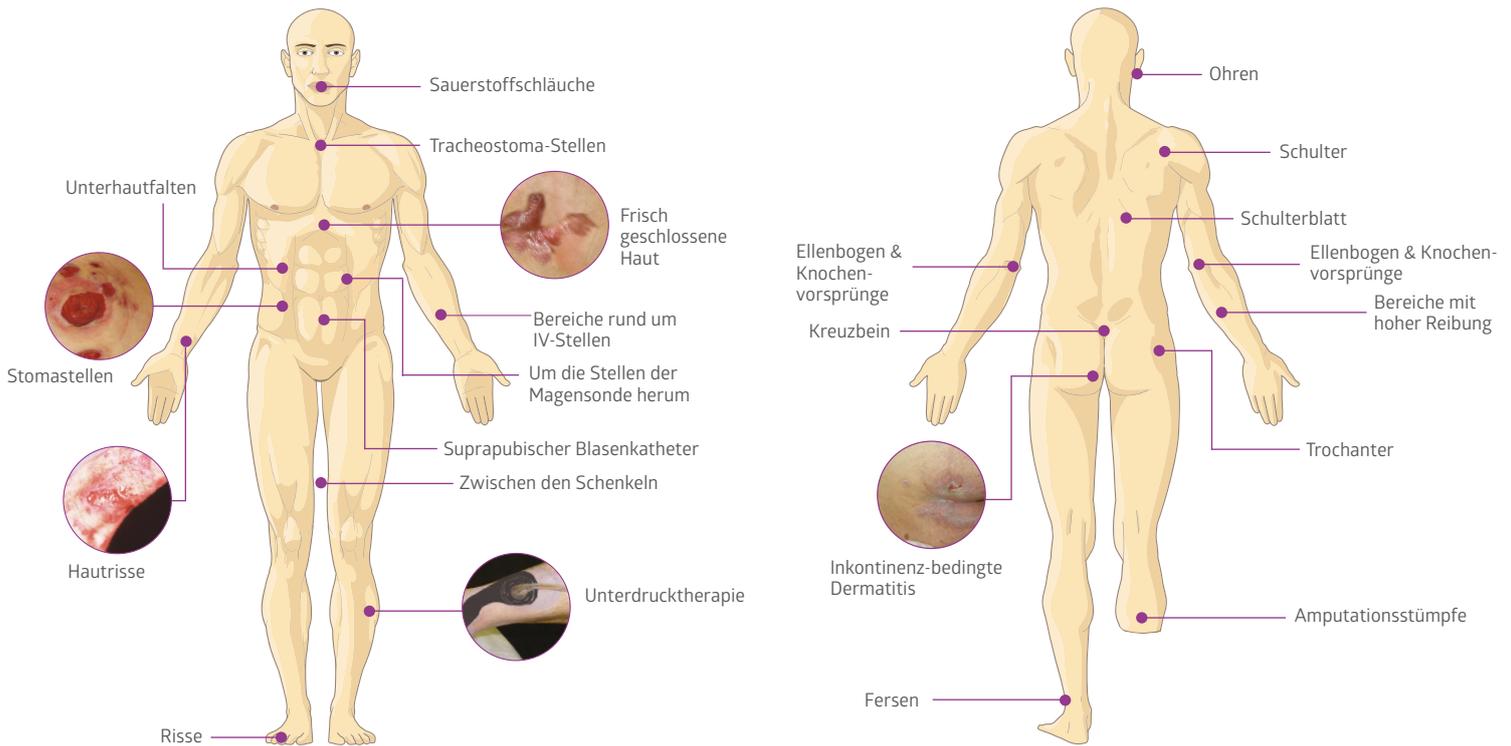

## Marathon® Praktische Größe für kleine Bereiche



MSC093001



## Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
MSC093001	Marathon® Cyanoacrylat Hautschutz	5 Stk./Box



**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Genf  
Schweiz

Tel.: +41 848 244 433

[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati  
Parkring 2  
1010 Wien  
Österreich  
Tel.: +43 800 201 878

[www.medline.eu/at](http://www.medline.eu/at)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

FOLLOW US

<sup>1</sup>Fletcher J, Beekman D, Boyles A et al (2020) International Best Practice Recommendations: Prevention and management of moisture-associated skin damage (MASD). Wounds International. 2010. Online verfügbar unter [www.woundsinternational.com](http://www.woundsinternational.com)  
<sup>2</sup>Kevin Y. Woo, PhD, NP, ist Assistenzprofessor, Queen's University, Kingston, Ontario, Kanada. Dimitri Beekman, PhD, RN, ist Professor, Universitätszentrum für Krankenpflege und Hebammenwesen, Universität Gent, Gent, Belgien. Debashish Chakravarty, PhD, ist Vizepräsident, Medline Industries, Inc. Northfield, Illinois. Die Autoren haben erklärt, dass es keine finanziellen Beziehungen im Hinblick auf diesen Artikel gibt. Eingereicht am 15. Dezember 2016; in überarbeiteter Form angenommen am 27. März 2017.  
<sup>3</sup>Margi R. Gefen A. Evaluation of facial tissue stresses under medical devices post application of a cyanoacrylate liquid skin protectant: An integrated experimental-computational study. Int Wound J. 2022 Mar;19(3):615-632. doi: 10.1111/iwj.13660. Epub 2021 Aug 17. PMID: 34402167; PMCID: PMC8874053.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein unsteriles Medizinprodukt der Klasse I, das für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt ist. Vor Gebrauch sollten die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett aufmerksam durchgelesen werden.



Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.  
© 2025 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1493\_DE 03/2025