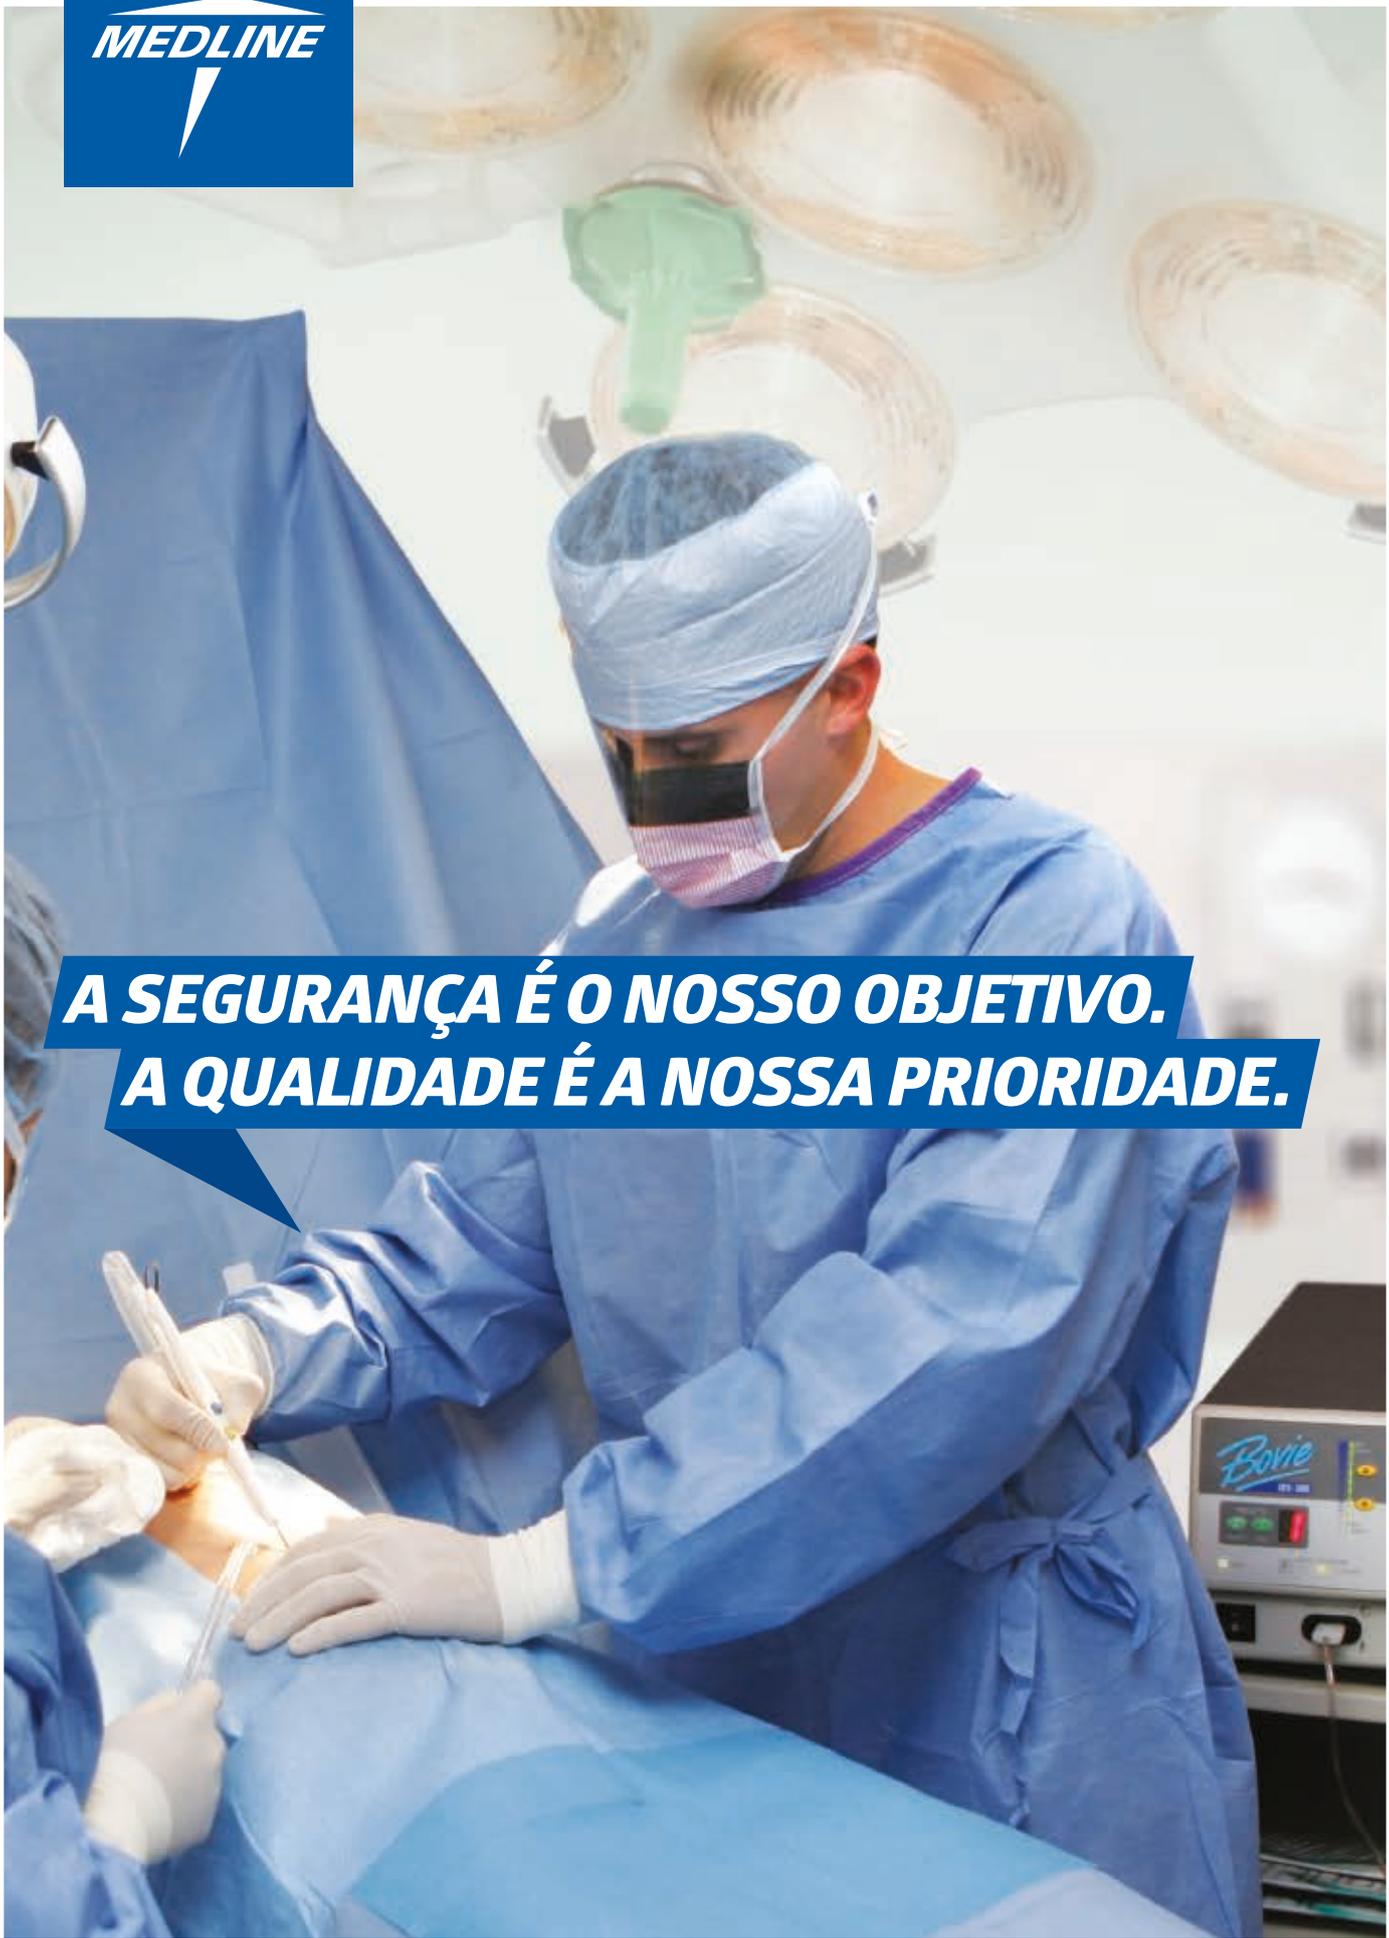


The logo for MEDLINE, featuring a stylized white starburst or lightning bolt shape above the word "MEDLINE" in a bold, white, sans-serif font, all set against a dark blue rectangular background.

**MEDLINE**

A photograph of a surgeon in a blue sterile gown, cap, and mask, focused on a surgical procedure. The surgeon is wearing white gloves and using a surgical instrument. The background shows an operating room with multiple overhead surgical lights and a piece of medical equipment labeled "Bovie" on the right side.

**A SEGURANÇA É O NOSSO OBJETIVO.  
A QUALIDADE É A NOSSA PRIORIDADE.**

**ELETROCIRURGIA**

# ÍNDICE

<b>BISTURI ELÉTRICO</b>	3
Por que utilizar os bisturis elétricos da Medline?	4
Bisturis elétricos com pontas de aço inoxidável standard	5
Bisturis elétricos com pontas revestidas com PTFE não aderentes	6
<b>ELÉTODOS ATIVOS ELETROCIRÚRGICOS (PONTAS)</b>	7
Eléttodos de aço inoxidável	8
Eléttodos revestidos com PTFE não aderente	9
<b>ACESSÓRIOS</b>	10
Dispositivo de limpeza das pontas eletrocirúrgicas	10
<b>SERVIÇO E APOIO</b>	11

# BISTURI ELÉTRICO

Com os produtos eletrocirúrgicos da Medline, tem tudo o que necessita: dispositivos de segurança únicos e uma gama completa de produtos de elevada qualidade e apoio inigualáveis.


Pode optar por bisturis esterilizados com botão e interruptor basculante. Os bisturis estão disponíveis individualmente ou com um estojo que ajuda a promover práticas de segurança, tal como recomendado por vários grupos como a Association for Perioperative Practice\* (AfPP).

A Medline oferece também um bisturi com uma ponta de politetrafluoretileno (PTFE) não aderente. Isto aumenta a eficiência e elimina os resíduos, pois não é necessário abrir uma ponta anti-aderente à parte, eliminando o custo adicional do desperdício da lâmina de aço inoxidável.

\*As normas e recomendações da AfPP sobre práticas perioperativas seguras em 2011 sugerem que o eléctrodo ativo deve ser armazenado em segurança num contentor não condutor quando não está a ser utilizado.

## POR QUE UTILIZAR OS BISTURIS ELÉTRICOS DA MEDLINE?

Concebidos exclusivamente para cirurgiões que preferem um toque mais tradicional, estes bisturis têm botões táteis, cabos com menos memória e fichas de elevada qualidade.

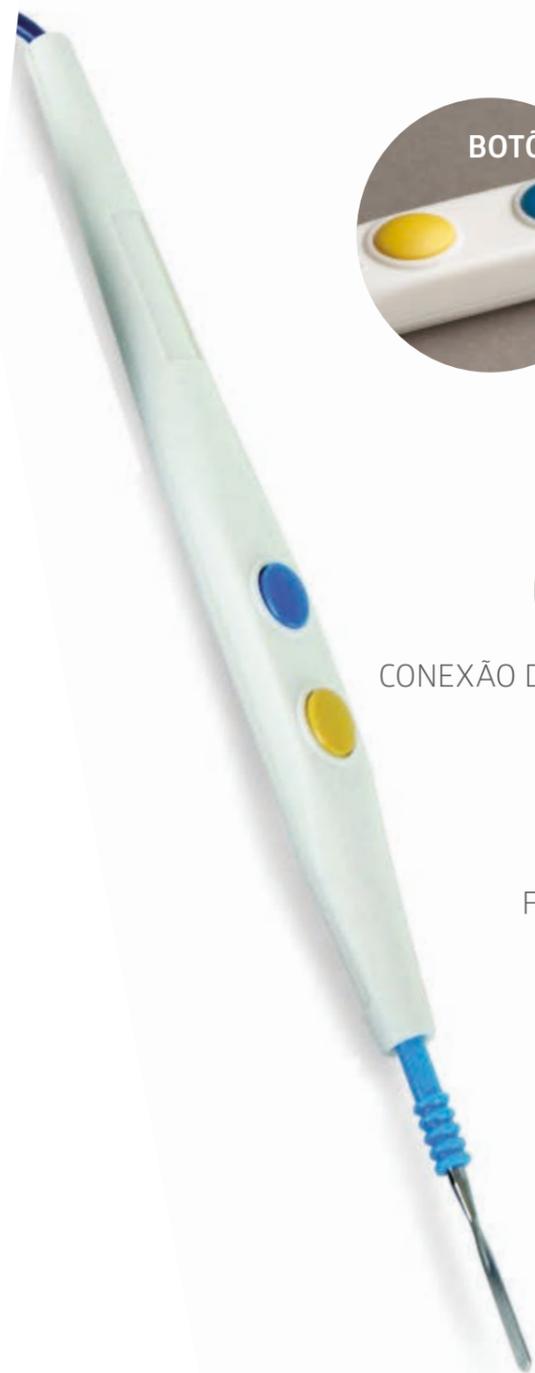

BOTÕES SUAVES



DE NÍQUEL



CONEXÃO DE UMA PEÇA



CABO SUAVE E FLEXÍVEL



FICHA DE MOLDE DUPLO

## BISTURIS ELÉTRICOS COM PONTAS DE AÇO INOXIDÁVEL

- Para a maioria dos elétrodos standard de 2,4 mm
- Fabricados de acordo com as normas da mais elevada qualidade, em conformidade com a Norma de Segurança de Equipamentos Eletromédicos IEC 60601-2-2
- Total garantia (consulte a página 7 sobre a garantia e política de indemnização)
- Disponível com ou sem estojo de segurança



### » Ponta de aço inoxidável standard, esterilizada<sup>1</sup>

Referência	Descrição	Embalagem	N.º do componente da embalagem
ESPB4000Q	Botão, elétrodo com lâmina, cabo de 3 m com estojo	60/caixa	ESPB4000NSA-EU
ESPB4001Q	Botão, elétrodo com lâmina, cabo de 3 m sem estojo	100/caixa	55729-EU
ESPB4000LQ	Botão, elétrodo com lâmina, fio de 5 m com estojo	60/caixa	55720A-EU + 82499-EU
ESPB4001LQ	Botão, elétrodo com lâmina, fio de 5 m sem estojo	80/caixa	55720A-EU
ESPB4001ERBQ	Botão, elétrodo com lâmina, conector ERBE, cabo de 3 m sem estojo	100/caixa	55721A-EU
ESRK4001Q	Botão basculante, elétrodo com lâmina, cabo de 3 m sem estojo	100/caixa	55722A-EU
ESRK4001LQ	Botão basculante, elétrodo com lâmina, cabo de 5 m sem estojo	80/caixa	n/a

## BISTURI ELÉTRICO COM PONTAS REVESTIDAS DE PTFE NÃO ADERENTES

Revestido com PTFE, o mesmo composto não aderente utilizado em Teflon®

- Permite a fácil limpeza do eletrodo com uma esponja ou uma gaze húmida em vez de uma lixa abrasiva
- As arestas arredondadas impedem que a corrente de radiofrequência concentre demasiada energia numa área
- Todas as pontas com menos de 7,62 cm de comprimento incluem um isolamento estriado que permite uma fácil substituição das pontas, mesmo em condições de humidade.




ESPB4002Q

» Ponta revestida com PTFE não aderente, esterilizada<sup>1</sup>

Referência	Descrição	Embalagem	N.º do componente da embalagem
ESPB4002Q	Botão, eletrodo com lâmina não aderente, cabo de 3 m com estojo	60/caixa	ESPB3002NSA-EU

## ELÉTRODOS ATIVOS ELETROCIRÚRGICOS (PONTAS)

A Medline fornece eletrodos ativos para as suas necessidades, em aço inoxidável ou revestidos com PTFE não aderente. Fornecemos eletrodos ativos de elevada qualidade, fabricados sob tolerâncias rigorosas. Todas as pontas com menos de 7,62 cm incluem um isolamento estriado para uma fácil substituição das pontas, mesmo em condições de humidade. Tem ao seu dispor uma gama completa de eletrodos ativos. As pontas standard de 2,4 mm ajustam-se à maioria dos bisturis elétricos.

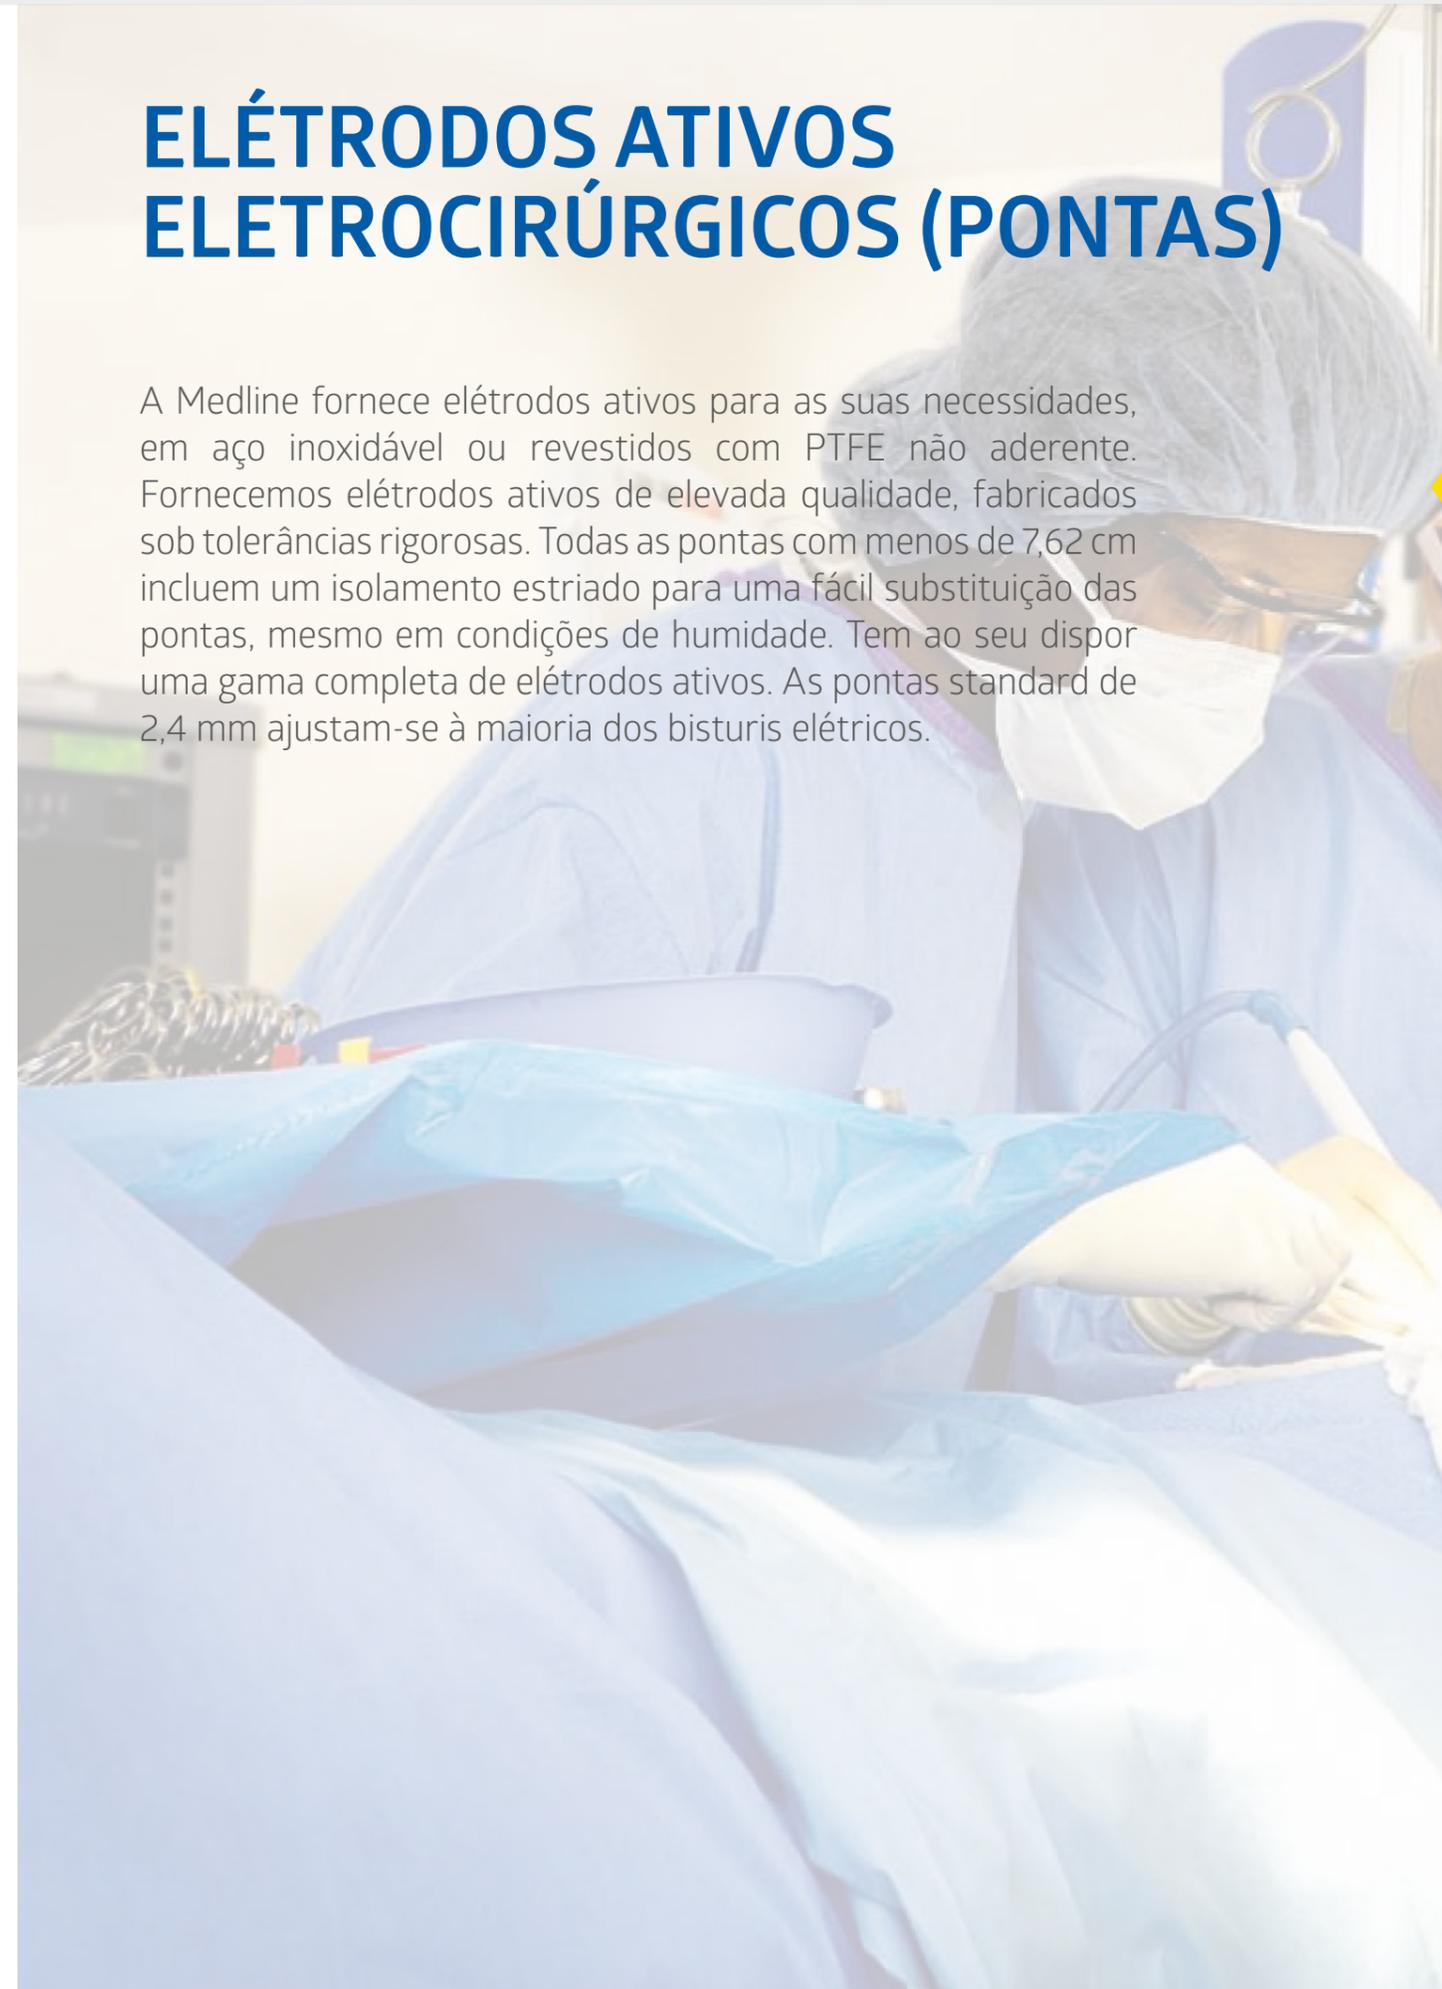

# ELÉTRODOS DE AÇO INOXIDÁVEL, DE USO ÚNICO, ESTERILIZADOS

Conexão standard de 2,4 mm, concebida para ajustar-se à maioria dos bisturis elétricos



## » Elérodos de aço inoxidável, de uso único, esterilizados<sup>2</sup>

Referência	Descrição	Embalagem	N.º do componente da embalagem
ESE1550EU	Eléetrodo esférico, 5 mm de diâmetro, 5 cm de comprimento	10/caixa	ESE1550AEU-NS
ESE1552EU	Eléetrodo de agulha, 7 cm	10/caixa	85511A-EU
ESE1551XEU	Eléetrodo de lâmina, 7 cm	10/caixa	85512A-EU
ESE15516EU	Eléetrodo de lâmina comprida, 15 cm	10/caixa	85513-EU
ESE15526EU	Eléetrodo de agulha comprida, 15 cm	10/caixa	85515-EU

# ELÉTRODOS REVESTIDOS COM PTFE NÃO ADERENTE, DE USO ÚNICO, ESTERILIZADOS

Revestidos com PTFE, o mesmo composto não aderente utilizado em Teflon®

- Conexão standard de 2,4 mm, concebida para ajustar-se à maioria dos bisturis elétricos
- Fácil limpeza do eléctrodo com uma esponja ou uma gaze húmida (em vez de uma lixa abrasiva)
- As arestas da lâmina arredondadas impedem que a corrente de radiofrequência concentre demasiada energia numa área
- Isolamento estriado para uma fácil substituição das pontas, mesmo em condições de humidade



## » Elérodos revestidos com PTFE não aderente, de uso único, esterilizados<sup>3</sup>

Referência	Descrição	Embalagem
ES0012AEU	Eléetrodo de lâmina, 7 cm	12/caixa
ES0012AMEU	Eléetrodo de lâmina, isolamento comprido, 7 cm	12/caixa
ES0013EU	Eléetrodo de agulha, 7 cm	12/caixa
ES0014AMEU	Eléetrodo de lâmina, isolamento aberto, 10 cm	12/caixa
ES0014EU	Eléetrodo de lâmina, 15 cm	12/caixa
ES0016EU	Eléetrodo de agulha, 15 cm	12/caixa

# ACESSÓRIOS

Os acessórios eletrocirúrgicos, como os dispositivos de limpeza e os estojos, podem ser tão essenciais para uma intervenção como o seu gerador. Os estojos de segurança são recomendados por associações de enfermagem como a AfPP\* para guardar bisturis de cauterização quando não estão a ser utilizados e podem ser indispensáveis para proteger os doentes e o utilizador. Para garantir que nunca fique sem produtos eletrocirúrgicos, necessita de um fornecedor que proporcione um tempo de resposta rápido e um serviço de excelência.

\*As normas e recomendações da AfPP sobre práticas perioperatórias seguras em 2011 sugerem que o eléctrodo ativo seja armazenado em segurança numa caixa não condutora quando não estiver a ser utilizado.

## DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA A PONTA ELETROCIRÚRGICA



- Para uma limpeza fácil e rápida das pontas de cauterização durante a cirurgia
- Radiopacas
- A base adesiva e robusta pode ser fixada facilmente em qualquer local.

### » Dispositivo de limpeza da ponta eletrocirúrgica, esterilizado<sup>4</sup>

Referência	Descrição	Embalagem	N.º do componente da embalagem
DYNJE01208	Polidor da ponta de eletrobisturi, 5 x 5 cm	100/cs	118438-EU

# SERVIÇO E APOIO

## A NOSSA GARANTIA

A Medline prima pela qualidade dos seus produtos eletrocirúrgicos, seja qual for o gerador com o qual são utilizados.

## GARANTIA E POLÍTICA DE INDEMNIZAÇÃO

Garantia: A Medline Industries, Inc. reconhece totalmente a sua responsabilidade como fabricante de produtos de cuidados de saúde e garante que foram tomadas as devidas precauções no fabrico dos seus produtos eletrocirúrgicos. A Medline irá substituir, gratuitamente, quaisquer produtos eletrocirúrgicos que não cumpram os padrões da Medline de fabrico, materiais e conceção, apesar da Medline não poder ser responsabilizada por danos após a entrega dos mesmos produtos devido a acidente, utilização inadequada ou abusiva, ou incumprimento das instruções fornecidas pela Medline. A presente política também abrange geradores eletrocirúrgicos, desde que quaisquer danos verificados nos mesmos tenham sido exclusivamente provocados por um produto eletrocirúrgico defeituoso da Medline ou devido a incompatibilidade do produto da Medline com o gerador eletrocirúrgico.

Indemnização: A Medline irá defender, exonerar de qualquer responsabilidade e indemnizar o cliente por todos e quaisquer julgamentos, perdas e despesas (incluindo, mas não se limitando a, honorários de advogados), referentes a qualquer reclamação de danos pessoais resultantes de ou provocados por qualquer defeito no produto eletrocirúrgico da Medline, desde que cada uma das seguintes quatro condições seja cumprida:

(A) intervenção cirúrgica na qual o tapete antiestático com ligação à terra é utilizado de acordo com as instruções da Medline e apenas quando for utilizado com um acessório ativo e um gerador eletrocirúrgico com um sistema de monitorização de contacto com o doente em boas condições, concebido para utilização com um tapete com fendas, fabricado por uma das seguintes empresas: Valleylab®, ConMed®, Aspen, Bard®, Birtcher, NDM, ERBE® e Bovie Medical.

(B) Os danos pessoais não foram provocados por negligência nem falta intencional por parte do cliente, nem resultam de uma modificação em qualquer máquina, tapete ou cabo.

(C) O cliente notifica a Medline da ocorrência num prazo razoável após o sucedido e fornece registos atempados de todas e quaisquer reclamações de danos alegadamente causados por produtos eletrocirúrgicos defeituosos da Medline, enviados por correio registado com aviso de receção para os escritórios da Medline, para Medline-Straße 1-3, 47533 Kleve, Alemanha, [www.medline.eu/contact-us](http://www.medline.eu/contact-us).

(D) A Medline assume a defesa e resolução de quaisquer reclamações e o cliente colabora totalmente nestas ações.

O presente acordo será considerado válido e vinculativo quando for aplicado pelo cliente e pela Medline. O presente acordo constitui o acordo final e completo entre o cliente e a Medline e cessa todos os prévios acordos e entendimentos escritos ou verbais anteriores relativos ao assunto do presente acordo. Irá aplicar-se a lei alemã quanto à interpretação e execução do presente acordo.



Para obter mais informações sobre os nossos produtos, visite [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt) ou contacte o seu representante de vendas local.



**ALWAYS ON.**

**Medline International Portugal, Unipessoal, Lda**  
 Campo Grande, 137, 1º dtº  
 Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande  
 1700 089 Lisboa  
 Portugal  
 Linha Azul: +351 808 291 921  
 Fax: +351 808 291 922  
[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

- Estes produtos são dispositivos médicos de Classe IIb e devem ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da sua utilização, consultar as instruções e precauções de uso no rótulo correspondente.
- Estes produtos são dispositivos médicos de Classe IIb e devem ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da sua utilização, consultar as instruções e precauções de uso no rótulo correspondente.
- Estes produtos são dispositivos médicos de Classe IIb e devem ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da sua utilização, consultar as instruções e precauções de uso no rótulo correspondente.
- Estes produtos são dispositivos médicos de Classe I e devem ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da sua utilização, consultar as instruções e precauções de uso no rótulo correspondente.



Latex free

CE 0482 Medcert GmbH



MedNet GmbH  
 Borkstraße 10  
 48163 Münster,  
 Germany



Latex free

CE 0120 SGS UK Limited



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
 Eiffelstraße 80  
 20537 Hamburg,  
 Germany



Latex free

CE 0413 Intertek Semko AB



Emergo Europe  
 Molenstraat 15  
 2519 BH, The Hague  
 The Netherlands



Latex free

CE 0086 BSI



Medline International France SAS  
 5 rue Charles Lindbergh  
 44110 Châteaubriant  
 France

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam estar presentes nesta brochura.

© 2019 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca registada da Medline Industries, Inc. Teflon é uma marca registada da E. I. du Pont de Nemours e empresa ou as respetivas filiais. ML250-PT04/FM 07/2019